



**FINESIA**<sup>®</sup>  
P R O D U C T L I S T

1 Piece



# FINESIA 1Piece

(単位:mm)

Diameter 直径	Φ3.0 Φ3.2 Φ3.4 Φ3.7 Φ4.2 Φ4.7
Height ポスト部高さ	7 (S) 9 (M) 11 (L)
Tip Type 先端形状	Tapered type (TP) or  Straight type (ST)
Surface 表面処理	HA (HAコーティング) or  AO (陽極酸化処理)
Length 骨内長	6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

## HAコーティング

(単位:mm)

Diameter (直径)			Φ3.4			Φ3.7			Φ4.2			Φ4.7			
Height (ポスト部高さ)			S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L	
			7	9	11	7	9	11	7	9	11	7	9	11	
Length (骨内長) / Tip Type (先端形状)	6.0	TP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	14.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## 陽極酸化処理

(単位:mm)

Diameter (直径)			Φ3.0			Φ3.2		
Height (ポスト部高さ)			S	M	L	S	M	L
			7	9	11	7	9	11
Length (骨内長) / Tip Type (先端形状)	8.0	TP	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	—	—	—
	10.0	TP	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	—	—	—
	12.0	TP	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	—	—	—
	14.0	TP	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	—	—	—

※ 一部の製品によっては受注生産品が含まれます。


## インプラント

HA

A0

インプラント

FINESIA 1P

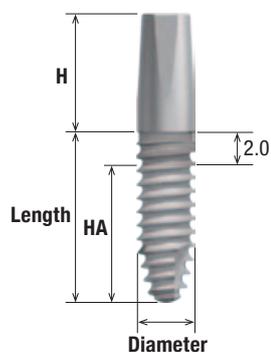

## 1P HA TP

Tapered type

Diameter  $\phi$  3.4 単位:mm

Length	HA	H	商品名	商品コード
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-34-8TP-S	BCD014380
		9.0	F1P-HA-34-8TP-M	BCD014381
		11.0	F1P-HA-34-8TP-L	BCD014382

10.0	8.0	7.0	F1P-HA-34-10TP-S	BCD014383
		9.0	F1P-HA-34-10TP-M	BCD014384
		11.0	F1P-HA-34-10TP-L	BCD014385

12.0	10.0	7.0	F1P-HA-34-12TP-S	BCD014386
		9.0	F1P-HA-34-12TP-M	BCD014387
		11.0	F1P-HA-34-12TP-L	BCD014388

14.0	12.0	7.0	F1P-HA-34-14TP-S	BCD014389
		9.0	F1P-HA-34-14TP-M	BCD014390
		11.0	F1P-HA-34-14TP-L	BCD014391

Diameter  $\phi$  3.7 単位:mm

Length	HA	H	商品名	商品コード
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-37-8TP-S	BCD014403
		9.0	F1P-HA-37-8TP-M	BCD014404
		11.0	F1P-HA-37-8TP-L	BCD014405


10.0	8.0	7.0	F1P-HA-37-10TP-S	BCD014406
		9.0	F1P-HA-37-10TP-M	BCD014407
		11.0	F1P-HA-37-10TP-L	BCD014408

12.0	10.0	7.0	F1P-HA-37-12TP-S	BCD014409
		9.0	F1P-HA-37-12TP-M	BCD014410
		11.0	F1P-HA-37-12TP-L	BCD014411

14.0	12.0	7.0	F1P-HA-37-14TP-S	BCD014412
		9.0	F1P-HA-37-14TP-M	BCD014413
		11.0	F1P-HA-37-14TP-L	BCD014414

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

表面処理 HA  
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

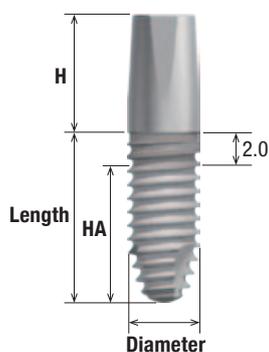

## 1P HA TP

Tapered type

Diameter			$\phi$ 4.2		単位:mm
----------	--	--	------------	--	-------

Length	HA	H	商品名	商品コード
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-42-8TP-S	BCD014423
		9.0	F1P-HA-42-8TP-M	BCD014424
		11.0	F1P-HA-42-8TP-L	BCD014425

10.0	8.0	7.0	F1P-HA-42-10TP-S	BCD014426
		9.0	F1P-HA-42-10TP-M	BCD014427
		11.0	F1P-HA-42-10TP-L	BCD014428

12.0	10.0	7.0	F1P-HA-42-12TP-S	BCD014429
		9.0	F1P-HA-42-12TP-M	BCD014430
		11.0	F1P-HA-42-12TP-L	BCD014431

14.0	12.0	7.0	F1P-HA-42-14TP-S	BCD014432
		9.0	F1P-HA-42-14TP-M	BCD014433
		11.0	F1P-HA-42-14TP-L	BCD014434

Diameter			$\phi$ 4.7		単位:mm
----------	--	--	------------	--	-------

Length	HA	H	商品名	商品コード
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-47-8TP-S	BCD014443
		9.0	F1P-HA-47-8TP-M	BCD014444
		11.0	F1P-HA-47-8TP-L	BCD014445

10.0	8.0	7.0	F1P-HA-47-10TP-S	BCD014446
		9.0	F1P-HA-47-10TP-M	BCD014447
		11.0	F1P-HA-47-10TP-L	BCD014448

12.0	10.0	7.0	F1P-HA-47-12TP-S	BCD014449
		9.0	F1P-HA-47-12TP-M	BCD014450
		11.0	F1P-HA-47-12TP-L	BCD014451

14.0	12.0	7.0	F1P-HA-47-14TP-S	BCD014452
		9.0	F1P-HA-47-14TP-M	BCD014453
		11.0	F1P-HA-47-14TP-L	BCD014454


Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 HA  
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

# 1P HA ST

Straight type

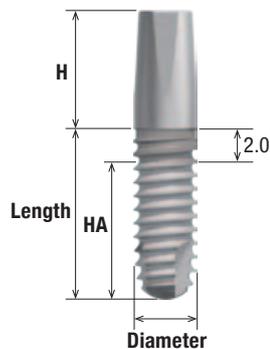


Diameter		$\phi 3.7$			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-37-6ST-S	BCD014300	
		9.0	F1P-HA-37-6ST-M	BCD014301	
		11.0	F1P-HA-37-6ST-L	BCD014302	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-37-8ST-S	BCD014303	
		9.0	F1P-HA-37-8ST-M	BCD014304	
		11.0	F1P-HA-37-8ST-L	BCD014305	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-37-10ST-S	BCD014306	
		9.0	F1P-HA-37-10ST-M	BCD014307	
		11.0	F1P-HA-37-10ST-L	BCD014308	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-37-12ST-S	BCD014309	
		9.0	F1P-HA-37-12ST-M	BCD014310	
		11.0	F1P-HA-37-12ST-L	BCD014311	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-37-14ST-S	BCD014312	
		9.0	F1P-HA-37-14ST-M	BCD014313	
		11.0	F1P-HA-37-14ST-L	BCD014314	

Diameter = (直径)    Length = (骨内長)



表面処理 HA  
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

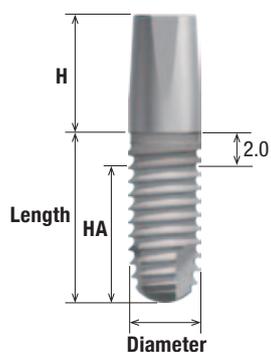

## 1P HA ST

Straight type

Diameter		$\phi 4.2$			単位: mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-42-6ST-S	BCD014320	
		9.0	F1P-HA-42-6ST-M	BCD014321	
		11.0	F1P-HA-42-6ST-L	BCD014322	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-42-8ST-S	BCD014323	
		9.0	F1P-HA-42-8ST-M	BCD014324	
		11.0	F1P-HA-42-8ST-L	BCD014325	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-42-10ST-S	BCD014326	
		9.0	F1P-HA-42-10ST-M	BCD014327	
		11.0	F1P-HA-42-10ST-L	BCD014328	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-42-12ST-S	BCD014329	
		9.0	F1P-HA-42-12ST-M	BCD014330	
		11.0	F1P-HA-42-12ST-L	BCD014331	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-42-14ST-S	BCD014332	
		9.0	F1P-HA-42-14ST-M	BCD014333	
		11.0	F1P-HA-42-14ST-L	BCD014334	


Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 HA  
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

# 1P HA ST

Straight type

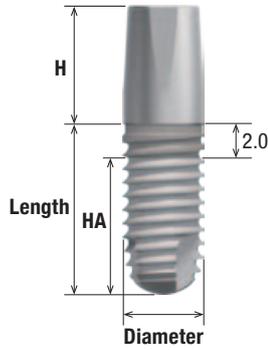


Diameter		$\phi 4.7$			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-47-6ST-S	BCD014338	
		9.0	F1P-HA-47-6ST-M	BCD014339	
		11.0	F1P-HA-47-6ST-L	BCD014340	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-47-8ST-S	BCD014341	
		9.0	F1P-HA-47-8ST-M	BCD014342	
		11.0	F1P-HA-47-8ST-L	BCD014343	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-47-10ST-S	BCD014344	
		9.0	F1P-HA-47-10ST-M	BCD014345	
		11.0	F1P-HA-47-10ST-L	BCD014346	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-47-12ST-S	BCD014347	
		9.0	F1P-HA-47-12ST-M	BCD014348	
		11.0	F1P-HA-47-12ST-L	BCD014349	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-47-14ST-S	BCD014350	
		9.0	F1P-HA-47-14ST-M	BCD014351	
		11.0	F1P-HA-47-14ST-L	BCD014352	

Diameter = (直径)    Length = (骨内長)



表面処理 HA  
Hydroxyapatite (ハイドロキシアパタイト)

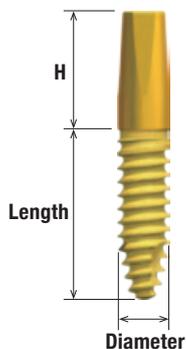

## 1P A0 TP

Tapered type

 **$\phi$  3.0** 単位:mm

Length	H	商品名	商品コード
8.0	7.0	F1P-A0-30-8TP-S	BCD014140
	9.0	F1P-A0-30-8TP-M	BCD014141
	11.0	F1P-A0-30-8TP-L	BCD014142
10.0	7.0	F1P-A0-30-10TP-S	BCD014143
	9.0	F1P-A0-30-10TP-M	BCD014144
	11.0	F1P-A0-30-10TP-L	BCD014145
12.0	7.0	F1P-A0-30-12TP-S	BCD014146
	9.0	F1P-A0-30-12TP-M	BCD014147
	11.0	F1P-A0-30-12TP-L	BCD014148
14.0	7.0	F1P-A0-30-14TP-S	BCD014149
	9.0	F1P-A0-30-14TP-M	BCD014150
	11.0	F1P-A0-30-14TP-L	BCD014151

 **$\phi$  3.2** 単位:mm

Length	H	商品名	商品コード
8.0	7.0	F1P-A0-32-8TP-S	BCD014160
	9.0	F1P-A0-32-8TP-M	BCD014161
	11.0	F1P-A0-32-8TP-L	BCD014162
10.0	7.0	F1P-A0-32-10TP-S	BCD014163
	9.0	F1P-A0-32-10TP-M	BCD014164
	11.0	F1P-A0-32-10TP-L	BCD014165
12.0	7.0	F1P-A0-32-12TP-S	BCD014166
	9.0	F1P-A0-32-12TP-M	BCD014167
	11.0	F1P-A0-32-12TP-L	BCD014168
14.0	7.0	F1P-A0-32-14TP-S	BCD014169
	9.0	F1P-A0-32-14TP-M	BCD014170
	11.0	F1P-A0-32-14TP-L	BCD014171

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

表面処理 A0  
Anode Oxidization(陽極酸化)



**FINESIA**

**インスツルメント**

# インスツルメント


AO  
 HA  
 インスツルメント  
 FINESIA 1P

## マーキングバー

インプラント体の植立予定位置にマーキングします。

商品名	商品コード
MARKING BUR-M	BCDI11001

単位:mm




## パイロットドリル 16

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL16-S	BCDI11002
38.5	22.0	●	PILOT DRL16-M	BCDI11003

単位:mm

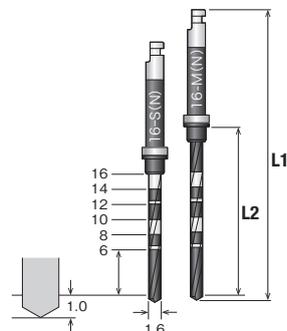


## パイロットドリル ストッパー 16

パイロットドリル 16 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER16-5	BCDI11010
6.0		PD STOPPER16-6	BCDI11011
7.0		PD STOPPER16-7	BCDI11012
8.0		PD STOPPER16-8	BCDI11013
9.0	●	PD STOPPER16-9	BCDI11014
10.0		PD STOPPER16-10	BCDI11015
11.0		PD STOPPER16-11	BCDI11016
12.0		PD STOPPER16-12	BCDI11017

(1個入)

単位:mm

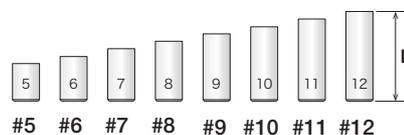


## トライアルピン

形成したパイロットホールの深さ及び方向を確認します。

L	商品名	商品コード
18.8	TRIAL PIN16-S	BCDI11140
24.8	TRIAL PIN16-M	BCDI11141

単位:mm




## パイロットドリル 22

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL22-S	BCDI11004
38.5	22.0	●	PILOT DRL22-M	BCDI11005

単位:mm

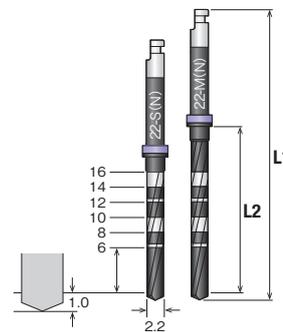


## パイロットドリル ストッパー 22

パイロットドリル 22 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER22-5	BCDI11018
6.0		PD STOPPER22-6	BCDI11019
7.0		PD STOPPER22-7	BCDI11020
8.0		PD STOPPER22-8	BCDI11021
9.0	●	PD STOPPER22-9	BCDI11022
10.0		PD STOPPER22-10	BCDI11023
11.0		PD STOPPER22-11	BCDI11024
12.0		PD STOPPER22-12	BCDI11025

単位:mm

(1個入)


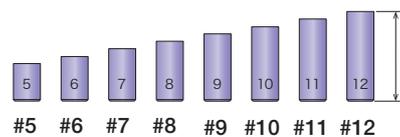


## ファイナルドリル TP

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7	●	FINAL DRL30-TP-S FINAL DRL30-TP-M	BCDI11030 BCDI11031
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.9	●	FINAL DRL32-TP-S FINAL DRL32-TP-M	BCDI11032 BCDI11033
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1	●	FINAL DRL34-TP-S FINAL DRL34-TP-M	BCDI11034 BCDI11035
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4	●	FINAL DRL37-TP-S FINAL DRL37-TP-M	BCDI11036 BCDI11037
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9	●	FINAL DRL42-TP-S FINAL DRL42-TP-M	BCDI11038 BCDI11039
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4	●	FINAL DRL47-TP-S FINAL DRL47-TP-M	BCDI11040 BCDI11041

単位:mm

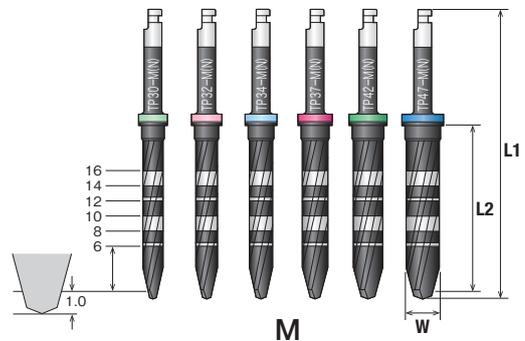
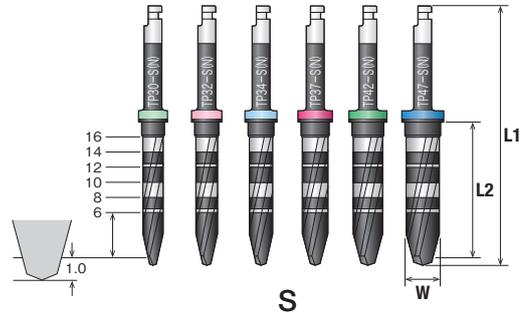


## ファイナルドリル ST

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7	●	FINAL DRL30-ST-S FINAL DRL30-ST-M	BCDI11050 BCDI11051
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.9	●	FINAL DRL32-ST-S FINAL DRL32-ST-M	BCDI11052 BCDI11053
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1	●	FINAL DRL34-ST-S FINAL DRL34-ST-M	BCDI11054 BCDI11055
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4	●	FINAL DRL37-ST-S FINAL DRL37-ST-M	BCDI11056 BCDI11057
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9	●	FINAL DRL42-ST-S FINAL DRL42-ST-M	BCDI11058 BCDI11059
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4	●	FINAL DRL47-ST-S FINAL DRL47-ST-M	BCDI11060 BCDI11061


単位:mm

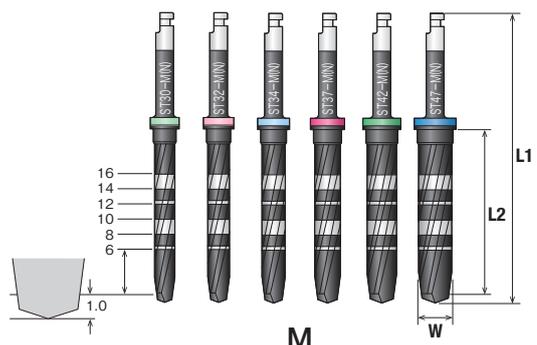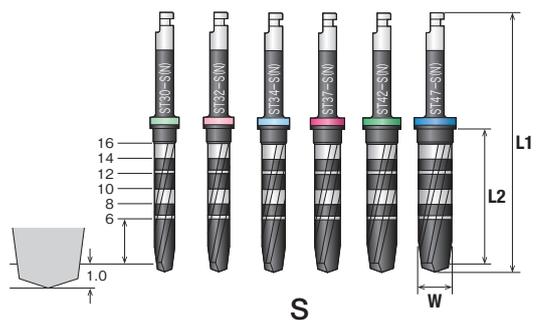


# ファイナルドリル ストッパー

ファイナルドリルに装着してインプラント窩の深さを調整します。


L	カラーコード	商品名	商品コード	
5.0	●	FD STOPPER30-5	BCDI11080	
6.0		FD STOPPER30-6	BCDI11081	
7.0		FD STOPPER30-7	BCDI11082	
8.0		FD STOPPER30-8	BCDI11083	
9.0		FD STOPPER30-9	BCDI11084	
10.0		FD STOPPER30-10	BCDI11085	
11.0		FD STOPPER30-11	BCDI11086	
12.0		FD STOPPER30-12	BCDI11087	
5.0		●	FD STOPPER32-5	BCDI11088
6.0			FD STOPPER32-6	BCDI11089
7.0			FD STOPPER32-7	BCDI11090
8.0			FD STOPPER32-8	BCDI11091
9.0	FD STOPPER32-9		BCDI11092	
10.0	FD STOPPER32-10		BCDI11093	
11.0	FD STOPPER32-11		BCDI11094	
12.0	FD STOPPER32-12		BCDI11095	
5.0	●		FD STOPPER34-5	BCDI11096
6.0			FD STOPPER34-6	BCDI11097
7.0			FD STOPPER34-7	BCDI11098
8.0			FD STOPPER34-8	BCDI11099
9.0		FD STOPPER34-9	BCDI11100	
10.0		FD STOPPER34-10	BCDI11101	
11.0		FD STOPPER34-11	BCDI11102	
12.0		FD STOPPER34-12	BCDI11103	
5.0		●	FD STOPPER37-5	BCDI11104
6.0			FD STOPPER37-6	BCDI11105
7.0			FD STOPPER37-7	BCDI11106
8.0			FD STOPPER37-8	BCDI11107
9.0	FD STOPPER37-9		BCDI11108	
10.0	FD STOPPER37-10		BCDI11109	
11.0	FD STOPPER37-11		BCDI11110	
12.0	FD STOPPER37-12		BCDI11111	
5.0	●		FD STOPPER42-5	BCDI11112
6.0			FD STOPPER42-6	BCDI11113
7.0			FD STOPPER42-7	BCDI11114
8.0			FD STOPPER42-8	BCDI11115
9.0		FD STOPPER42-9	BCDI11116	
10.0		FD STOPPER42-10	BCDI11117	
11.0		FD STOPPER42-11	BCDI11118	
12.0		FD STOPPER42-12	BCDI11119	
5.0		●	FD STOPPER47-5	BCDI11120
6.0			FD STOPPER47-6	BCDI11121
7.0			FD STOPPER47-7	BCDI11122
8.0			FD STOPPER47-8	BCDI11123
9.0	FD STOPPER47-9		BCDI11124	
10.0	FD STOPPER47-10		BCDI11125	
11.0	FD STOPPER47-11		BCDI11126	
12.0	FD STOPPER47-12		BCDI11127	

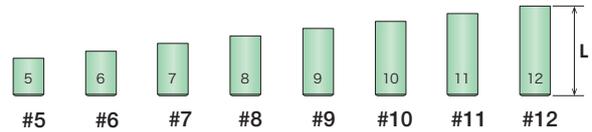


30

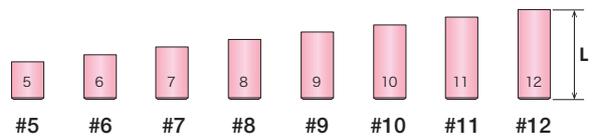


32

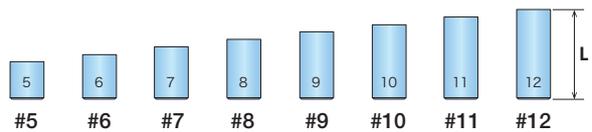


34

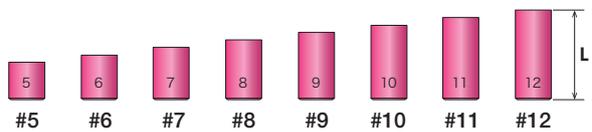

37

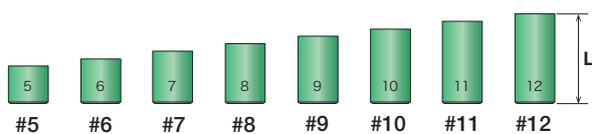

42

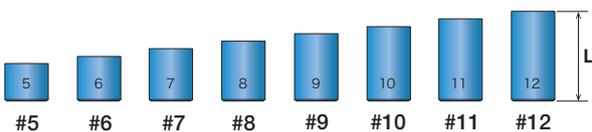

47

(1個入)

単位:mm


AO  
HA  
インスツルメント  
FINESIA 1P

## トライアルガイド TP

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
1.0	TRIAL GUIDE-TP-30	BCDI11150
	TRIAL GUIDE-TP-32	BCDI11151
	TRIAL GUIDE-TP-34	BCDI11152
0.9	TRIAL GUIDE-TP-37	BCDI11153
	TRIAL GUIDE-TP-42	BCDI11154
	TRIAL GUIDE-TP-47	BCDI11155

単位:mm

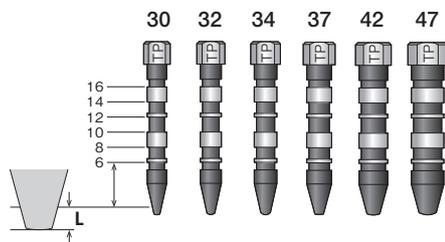


## トライアルガイド ST

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.8	TRIAL GUIDE-ST-37	BCDI11163
	TRIAL GUIDE-ST-42	BCDI11164
	TRIAL GUIDE-ST-47	BCDI11165

単位:mm




## タップフォーマー TP

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
2.9	TAP FORMER-TP-30	BCDI11180
3.1	TAP FORMER-TP-32	BCDI11181
3.3	TAP FORMER-TP-34	BCDI11182
3.6	TAP FORMER-TP-37	BCDI11183
4.1	TAP FORMER-TP-42	BCDI11184
4.6	TAP FORMER-TP-47	BCDI11185

単位:mm

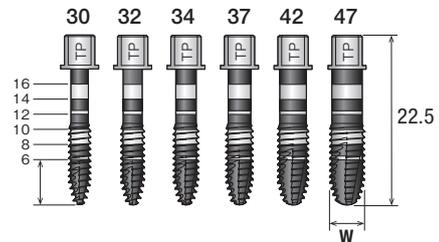


## タップフォーマー ST

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
3.6	TAP FORMER-ST-37	BCDI11193
4.1	TAP FORMER-ST-42	BCDI11194
4.6	TAP FORMER-ST-47	BCDI11195

単位:mm




## ドリルエクステンダー

コントラハンドピースに装着する器具に対して、隣在歯等が障害となった場合あるいは部位により高径が不足となった場合に装着して使用します。

商品名	商品コード
DRL EXTENDER	BCDI11235

単位:mm




## ヘキサロビューラドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。  
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
16.0	HEXALO DRIVER-XS-CH	BCDI11240
20.0	HEXALO DRIVER-S-CH	BCDI11241
24.0	HEXALO DRIVER-M-CH	BCDI11242
28.0	HEXALO DRIVER-L-CH	BCDI11243

単位:mm

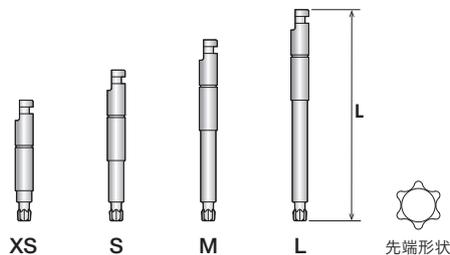


## ヘキサロビューラドライバー SH

各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.0	HEXALO DRIVER-XS-SH	BCDI11244
8.0	HEXALO DRIVER-S-SH	BCDI11245
12.0	HEXALO DRIVER-M-SH	BCDI11246
16.0	HEXALO DRIVER-L-SH	BCDI11247

単位:mm

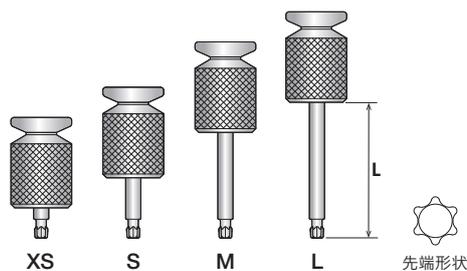


## ヘキサロビューラドライバー WH

DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。  
各種キャップ、スクリューの運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.5	HEXALO DRIVER-XS-WH	BCDI11248
6.5	HEXALO DRIVER-S-WH	BCDI11249
8.5	HEXALO DRIVER-M-WH	BCDI11250
12.5	HEXALO DRIVER-L-WH	BCDI11251

単位:mm

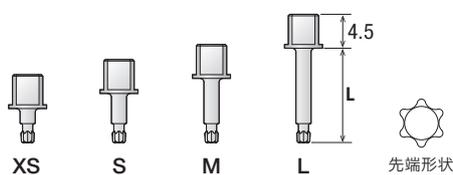


## ドライバー

1Pインプラント体の最終埋入に使用します。

W	商品名	商品コード
4.6	F1P-I DRIVER-30	BCDI11330
4.8	F1P-I DRIVER-32	BCDI11331
5.0	F1P-I DRIVER-34	BCDI11332
5.3	F1P-I DRIVER-37	BCDI11333
5.8	F1P-I DRIVER-42	BCDI11334
6.3	F1P-I DRIVER-47	BCDI11335

単位:mm

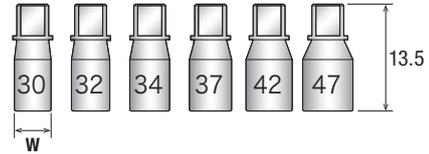


## トルクレンチ

DAアダプタまたはCHアダプタまたはFDアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。  
インプラント体埋入時のトルクが確認できます。

商品名	商品コード
TORQUEWRENCH	BCDI11286

単位:mm

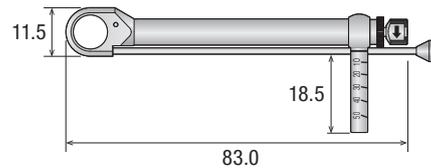


## FD アダプタ

トルクレンチ、インプラントドライバーCHを装着し使用します。

商品名	商品コード
FD ADAPTER	BCDI11289

単位:mm




## DA アダプタ

トルクレンチ、各種ドライバーWHを装着し使用します。

商品名	商品コード
DA ADAPTER	BCDI11287

単位:mm




※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。

## CH アダプタ

トルクレンチ、ヘキサロドライバーCH、  
フレックスドライバーCHを装着し使用します。

商品名	商品コード
CH ADAPTER	BCDI11288

単位:mm




## トルクレンチセット

トルクレンチ本体、DAアダプタのセットです。

商品名	商品コード
TORQUE WRENCH SET	BCDI11290

単位:mm

※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。

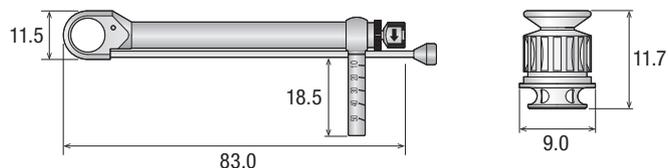


## ドライバーホルダー

ヘキサロドライバーWH、BLインプラントドライバーWHに装着し使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER	BCDI11295

単位:mm




## ドライバーエクステンダー

インプラント体の植立、埋入時に隣在歯等が障害となった場合、  
DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着して高径を確保します。

商品名	商品コード
DRIVER EXTENDER	BCDI11296

単位:mm




## ドライバーホルダー C

コントラハンドピースに装着してインプラント体の埋入に使用します。

H	商品名	商品コード
21.1	DRIVER HOLDER C-S	BCDI11275
29.1	DRIVER HOLDER C-L	BCDI11276

(ドライバーホルダーCリング10個入) 単位:mm



## ドライバーホルダー C リング

ドライバーホルダーCに装着して使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER C RING	BCDI11277

(30個入) 単位:mm




## ボールアバットメントキャリアー

ボールアバットメントの運搬に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB CARRIER	BCDI11311

単位:mm




## ボールアバットメントドライバー

ボールアバットメントの締結に使用します。

商品名	商品コード
F-BALL AB DRIVER-CH	BCDI11310



単位:mm



## サージカルケース

STあるいはTPのBL、TL、1Pのインスツルメントが収納できます。



商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE	BCDI12000

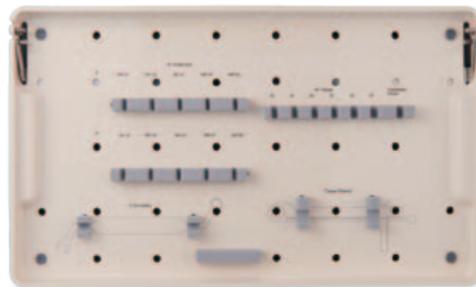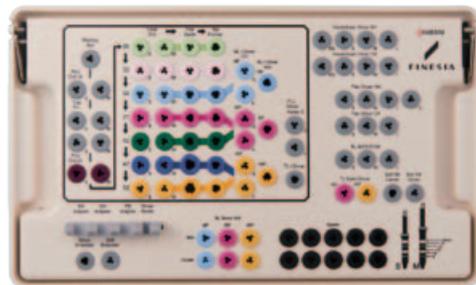

## サージカルケース S

使用頻度の高いインスツルメントを選択して収納できます。


商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE-S	BCDI12001

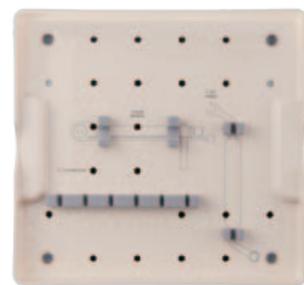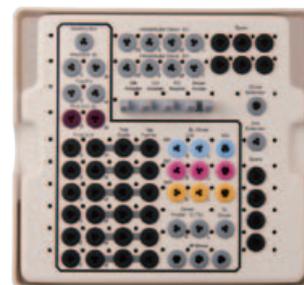

## プロステティックケース

二次手術以降に使用するインスツルメントを収納できます。

商品名	商品コード
F-PROSTHETIC CASE	BCDI12003

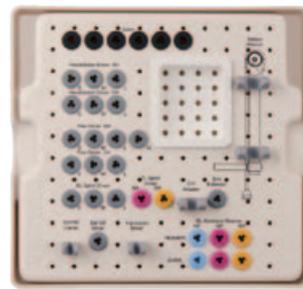

## ストッパーケース

ストッパー全サイズが収納でき、サイズを選択と装着が容易になります。

商品名	商品コード
F-STOPPER CASE	BCDI12002



## ストッパーピックアップ

ファイナルドリルストッパーを把持し、運搬する際に使用します。

商品名	商品コード
F-STOPPER PICK UP	BCDI12005



販売名	承認 / 認証 / 届出番号
F I N E S I A 1 Pフィクスチャー ファイナフィックス	22700BZX00253000
F I N E S I A 1 Pフィクスチャー ファイナタイト	22700BZX00270000
F I N E S I A インプラント用手術器具	26B1X10012101122
F I N E S I A 技工用器具	26B1X10012102114
F I N E S I A 印象採得用器具	26B1X10012102115
歯科用トルクレンチ	26B1X10012108103
ドライバーホルダーC	26B1X10012106106









## 京セラ株式会社

メディカル事業部 <https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501  
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 1・Sビル 〒140-8810  
Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001  
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31(住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004  
Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003  
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826  
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013  
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



[www.finesia.world](http://www.finesia.world)

■禁無断転載、複写

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2020年6月時点のものです。  
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。