POI 2Piece

販売期間	開始	1991年 2002年
	終了	現行

ボディ形状	Straight
コネクション	Internal HEX

インプラントサイズのバリエーション　単位（mm）

幅径	骨内長							カラー部
3.2	8	10	12	14	16	18	20	2.0
3.7	8	10	12	14	16	18	20	2.0
4.2	8	10	12	14	16	18	20	2.0

インプラントコネクション部　インターナル・ヘックス・バットコネクション

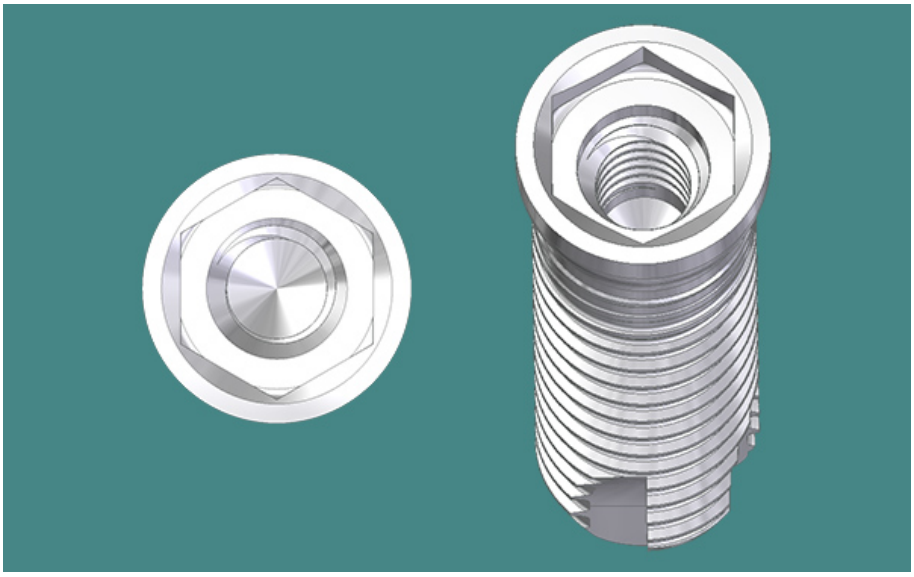

インプラント体-ストレートポストアバットメント装着時



ドライバー：
フレックス ドライバー

対辺距離：
1.1mm

スクリュー：
ロックスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.4mm



ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC

マイナス溝幅：
0.5mm

スクリュー：
旧ロックスクリュー
（マイナス溝）

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.4mm

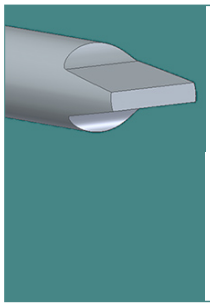

ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC

マイナス溝幅：
0.5mm

スクリュー：
旧ロックスクリュー
（プラス溝）

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.4mm

インプラント体-プラスチックコネクター/ゴールドコネクター装着時



ドライバー：
フレックス ドライバー

対辺距離：
1.1mm

スクリュー：
コロナルスクリュー

幅径	対辺距離	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径
全サイズ	1.1mm	M2.0	2.6mm



ドライバー：
ドライバーS
ドライバーC

マイナス溝幅：
0.5mm

スクリュー：
旧コロナルクリュー
（マイナス溝）

幅径	溝幅	スクリュー径	アバットメントのアクセスホール径
全サイズ	0.5mm	M2.0	2.6mm

インプラント体-スクリューポスト/アタッチメントメール（スクリューなし）装着時



ドライバー：
フレックス ドライバー

対辺距離：
1.1mm

インプラント体-TXキーパーホルダー（スクリューなし）装着時



ドライバー：
TXドライバー

対辺距離：
1.4mm