

破折したアバットメントスクリューの除去方法

スクリューの破折片を除去するには下記の方法をお試しください。

① 探針など先端の鋭利な
インスツルメントを使用する。




② 超音波スケーラーを使用する。



③ 破折片にグルーブを形成して、
マイナスドライバーを使用する。



注意点：・インプラント体内部を決して傷付けないように注意し、傷が付いていないか確認してください。
・新しいアバットメントスクリューを試適し、スムーズにねじ込めることを確認してください。
・内部の状態により適正なトルクで締め込めない場合があります。

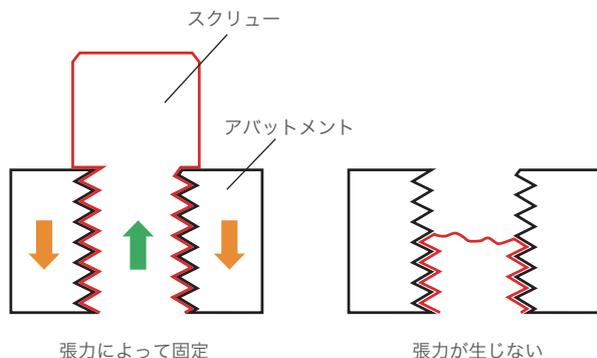

アバットメントとスクリューは張力により固定されていますが、破折により頭部を失ったものには加わっていないため、基本的には残存部を反時計方向に回転することで除去可能であることが多いといわれています。

「SAFE Troubleshooting Guide Volume 1 (P.39)」
(クインテッセンス出版株式会社) より

【薬事承認番号】

FINESIA BLフィクスチャー ファイナフィックス 【22800BZX00034000】
FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト 【22800BZX00035000】
FINESIA BLアバットメント 【22800BZX00036000】
FINESIA BLチタンベースアバットメント 【22900BZX00097000】

